


Influência da ultrassonografia Doppler nas falhas de fistulas arteriovenosas de diálise relacionada a alguns fatores de risco

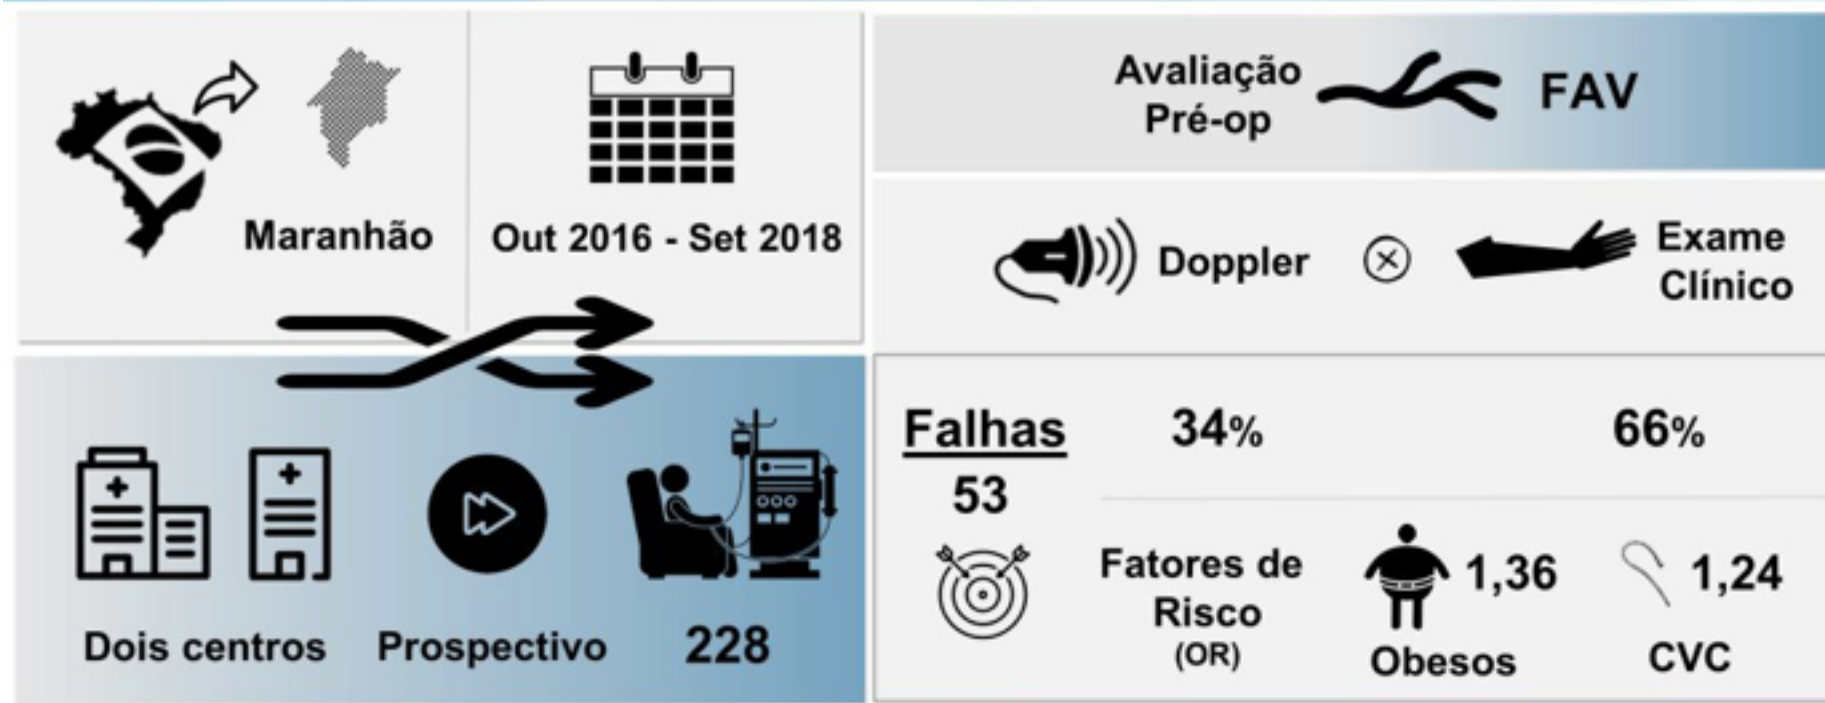

Conclusões: A redução de falhas com a introdução do Doppler foi estatisticamente significativa na amostra geral, mas só foi possível estabelecer uma relação entre fatores de risco específicos e falha em dois dos fatores estudados, obesidade e cateter venoso central no mesmo lado da FAV.

Lopes JRA, Marques ALB, Correa JA. Influência da ultrassonografia Doppler nas falhas de fistulas arteriovenosas de diálise relacionada a alguns fatores de risco. Braz J Nephrol. 2020 [Visual abstract por Moura Neto](#)